

ЛАПАРОСКОПИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ

И

ИНСТРУМЕНТЫ












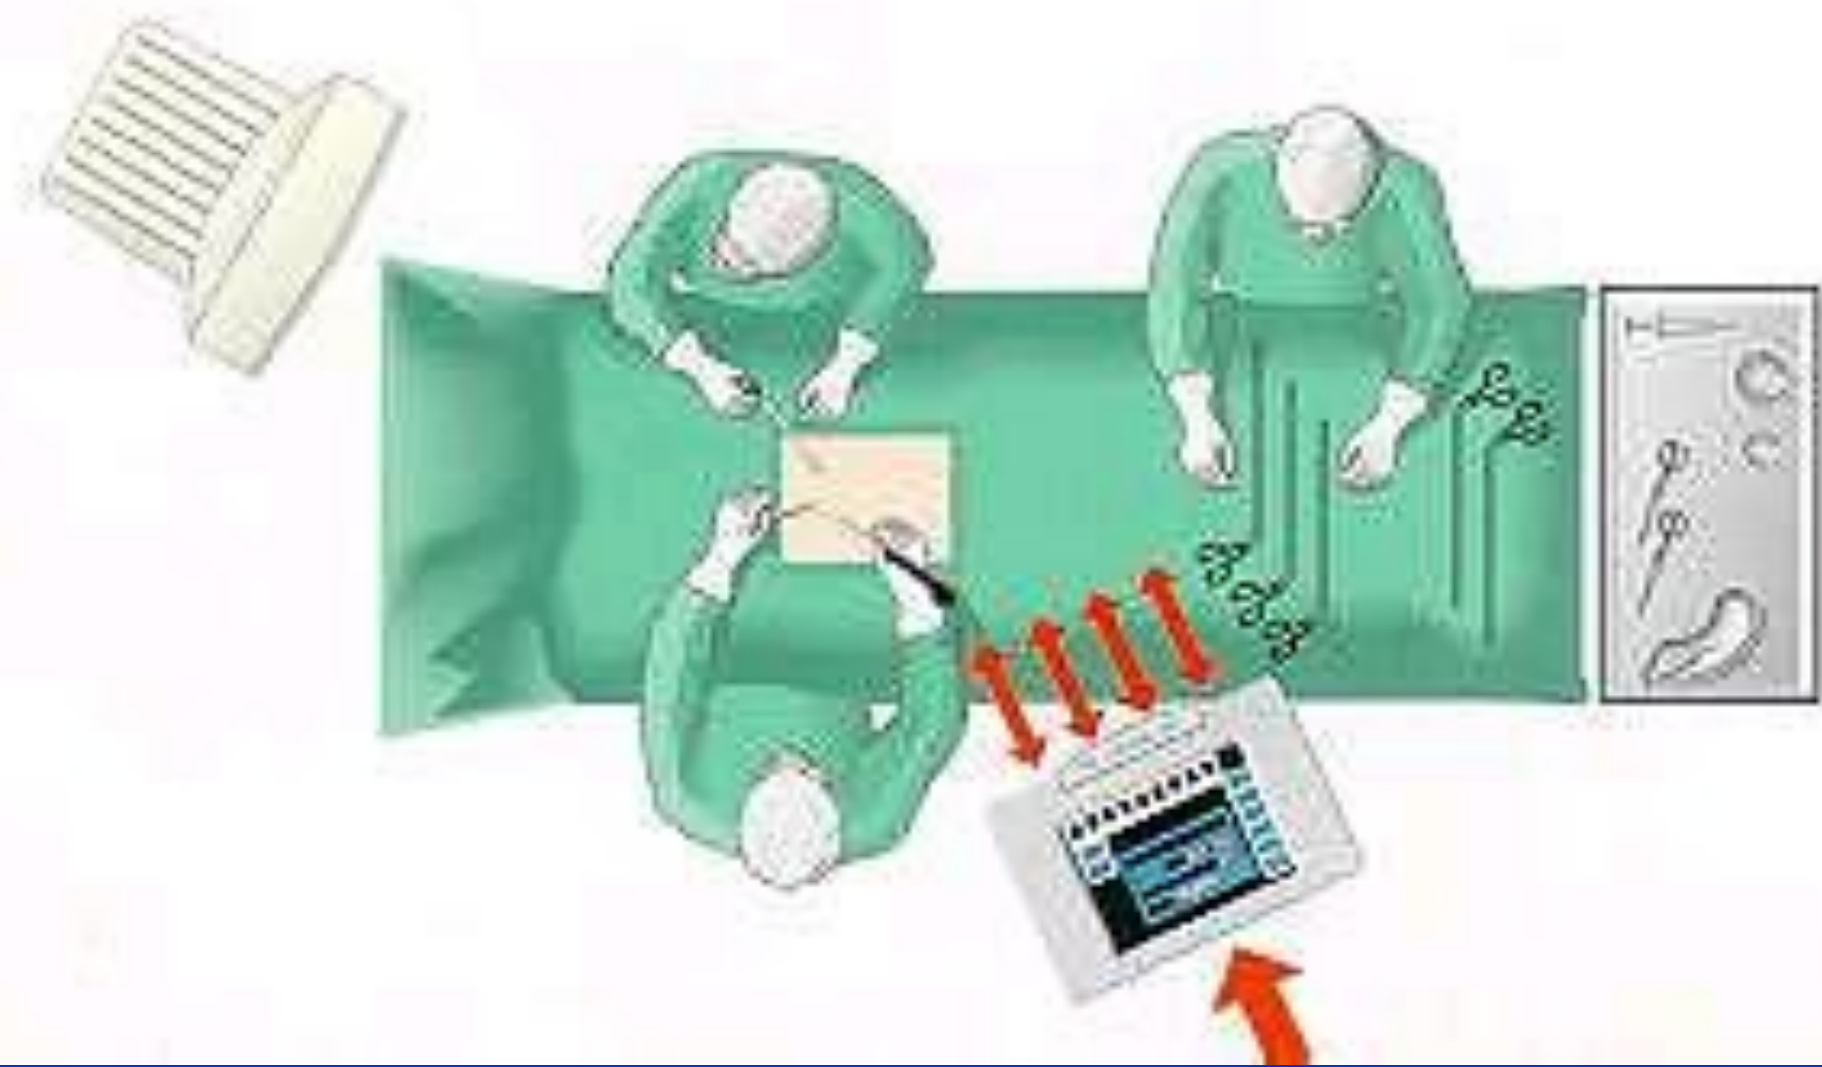



- Leistungsmerkmale:**
- Vollautomatische Atemsteuerung
 - Atemvolumen- und Atemfrequenzüberwachung
 - Atemdrucküberwachung
 - Atemflussüberwachung
 - Atemtemperaturüberwachung
 - Atemzeitüberwachung
 - Atemwegsdrucküberwachung
 - Atemwegsfeuchtigkeitüberwachung
 - Atemwegsdrucküberwachung
 - Atemwegsfeuchtigkeitüberwachung
- Leistungsmerkmale:**
- Vollautomatische Atemsteuerung
 - Atemvolumen- und Atemfrequenzüberwachung
 - Atemdrucküberwachung
 - Atemflussüberwachung
 - Atemtemperaturüberwachung
 - Atemzeitüberwachung
 - Atemwegsdrucküberwachung
 - Atemwegsfeuchtigkeitüberwachung
 - Atemwegsdrucküberwachung
 - Atemwegsfeuchtigkeitüberwachung

Leistungsmerkmale

Leistungsmerkmale


Leistungsmerkmale

- Leistungsmerkmale:**
- Vollautomatische Atemsteuerung
 - Atemvolumen- und Atemfrequenzüberwachung
 - Atemdrucküberwachung
 - Atemflussüberwachung
 - Atemtemperaturüberwachung
 - Atemzeitüberwachung
 - Atemwegsdrucküberwachung
 - Atemwegsfeuchtigkeitüberwachung
 - Atemwegsdrucküberwachung
 - Atemwegsfeuchtigkeitüberwachung

- Leistungsmerkmale:**
- Vollautomatische Atemsteuerung
 - Atemvolumen- und Atemfrequenzüberwachung
 - Atemdrucküberwachung
 - Atemflussüberwachung
 - Atemtemperaturüberwachung
 - Atemzeitüberwachung
 - Atemwegsdrucküberwachung
 - Atemwegsfeuchtigkeitüberwachung
 - Atemwegsdrucküberwachung
 - Atemwegsfeuchtigkeitüberwachung





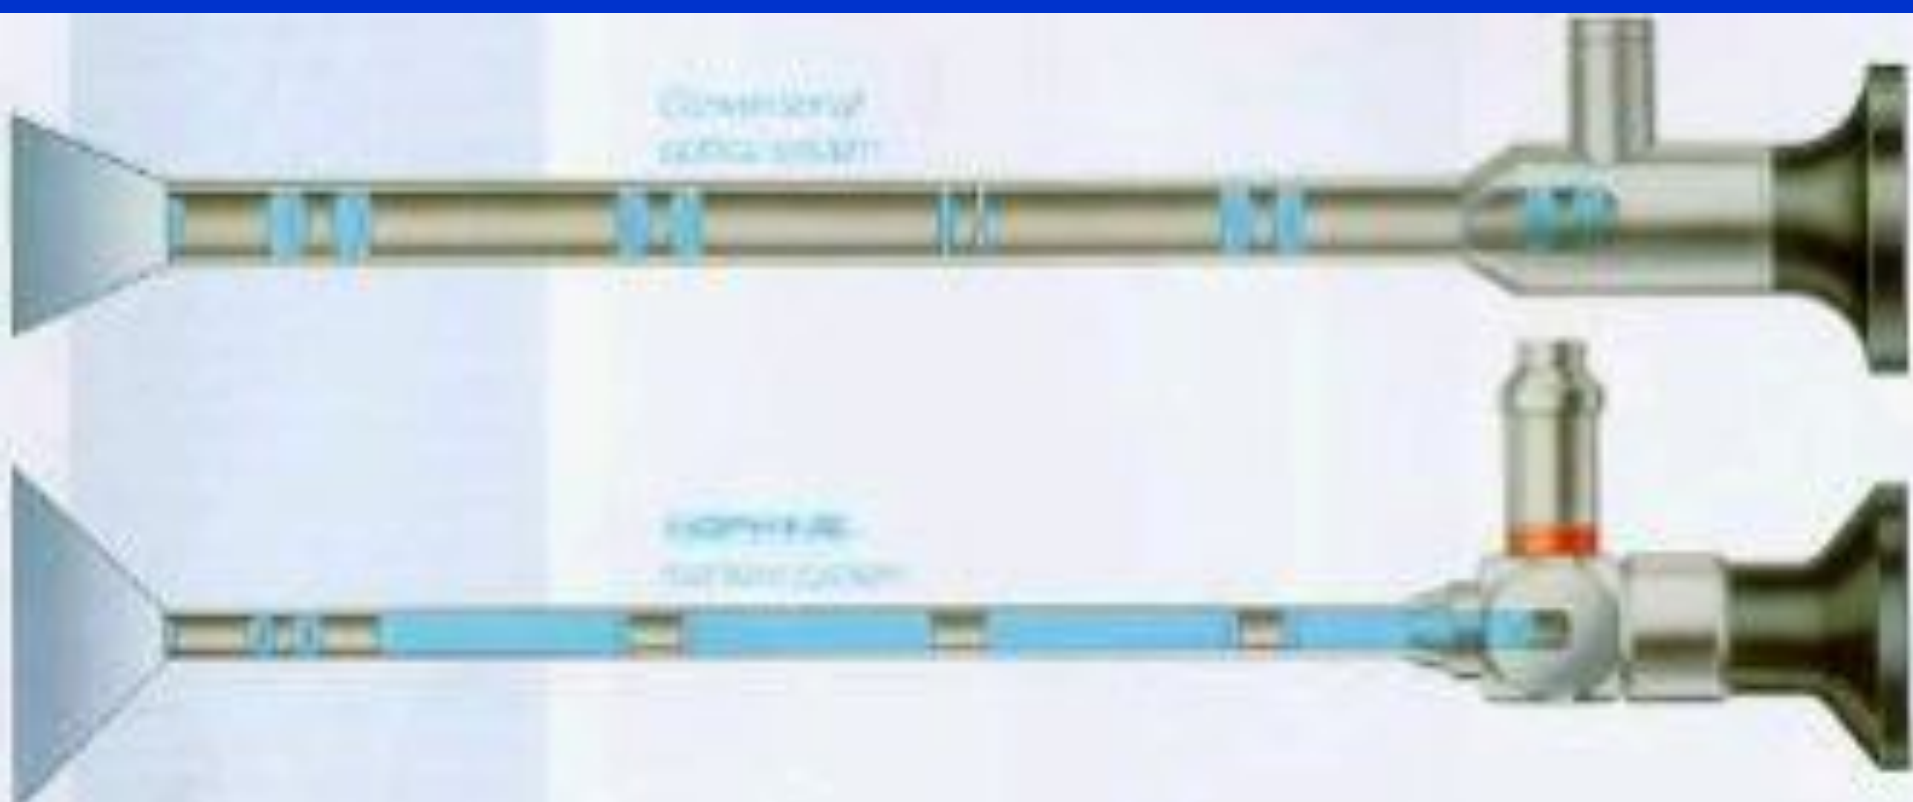









STORZ

Faint, illegible text on the top surface of the base unit, likely technical specifications or safety instructions.

STORZ
KARLSRUHE - HEIDELBERG

202800 20

Power switch, green indicator light, and warning symbol.


Power cord connector and CE mark.









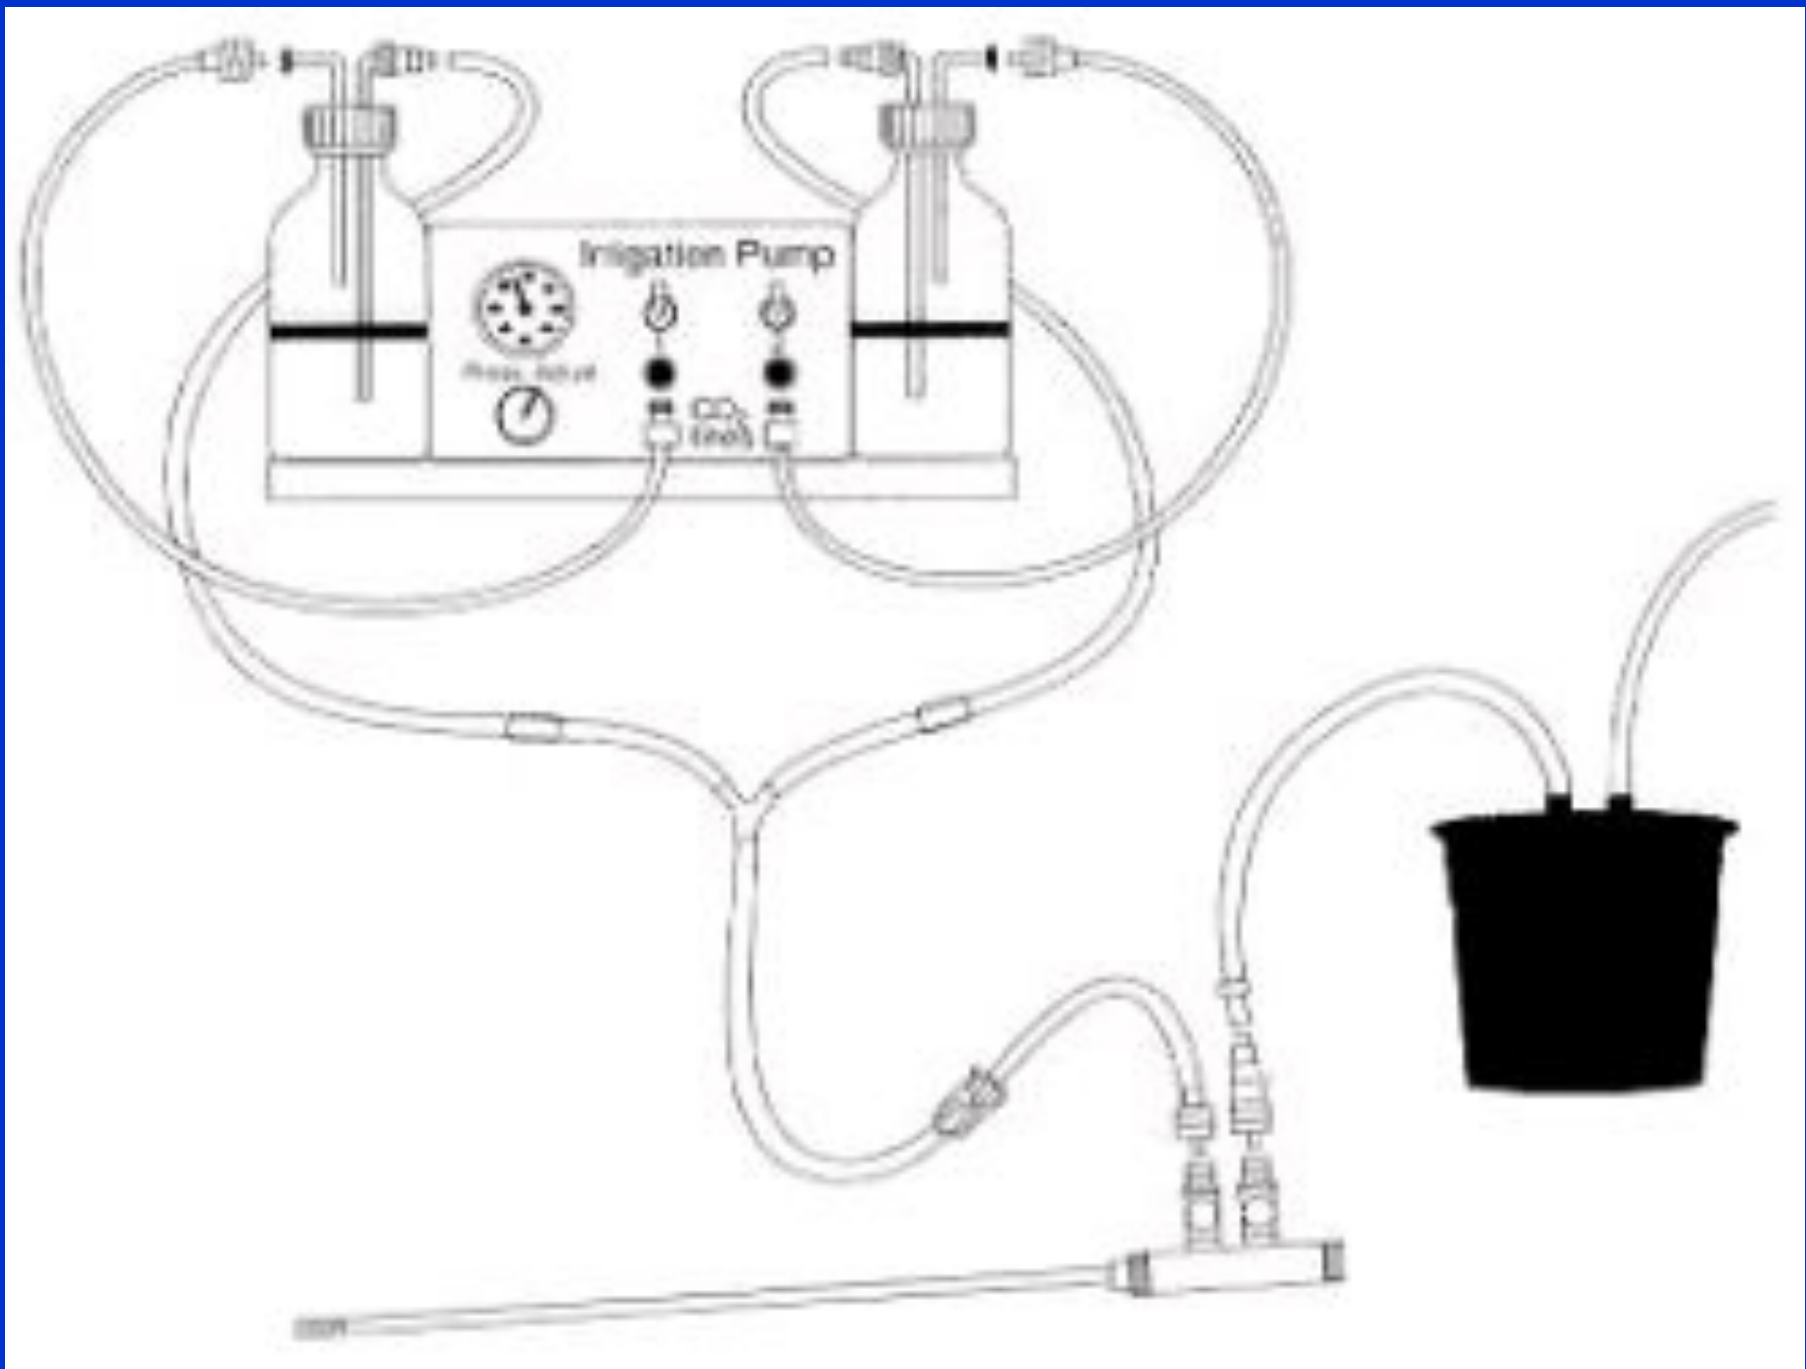





























AutoSpray
VISIPORT Series - 11mm












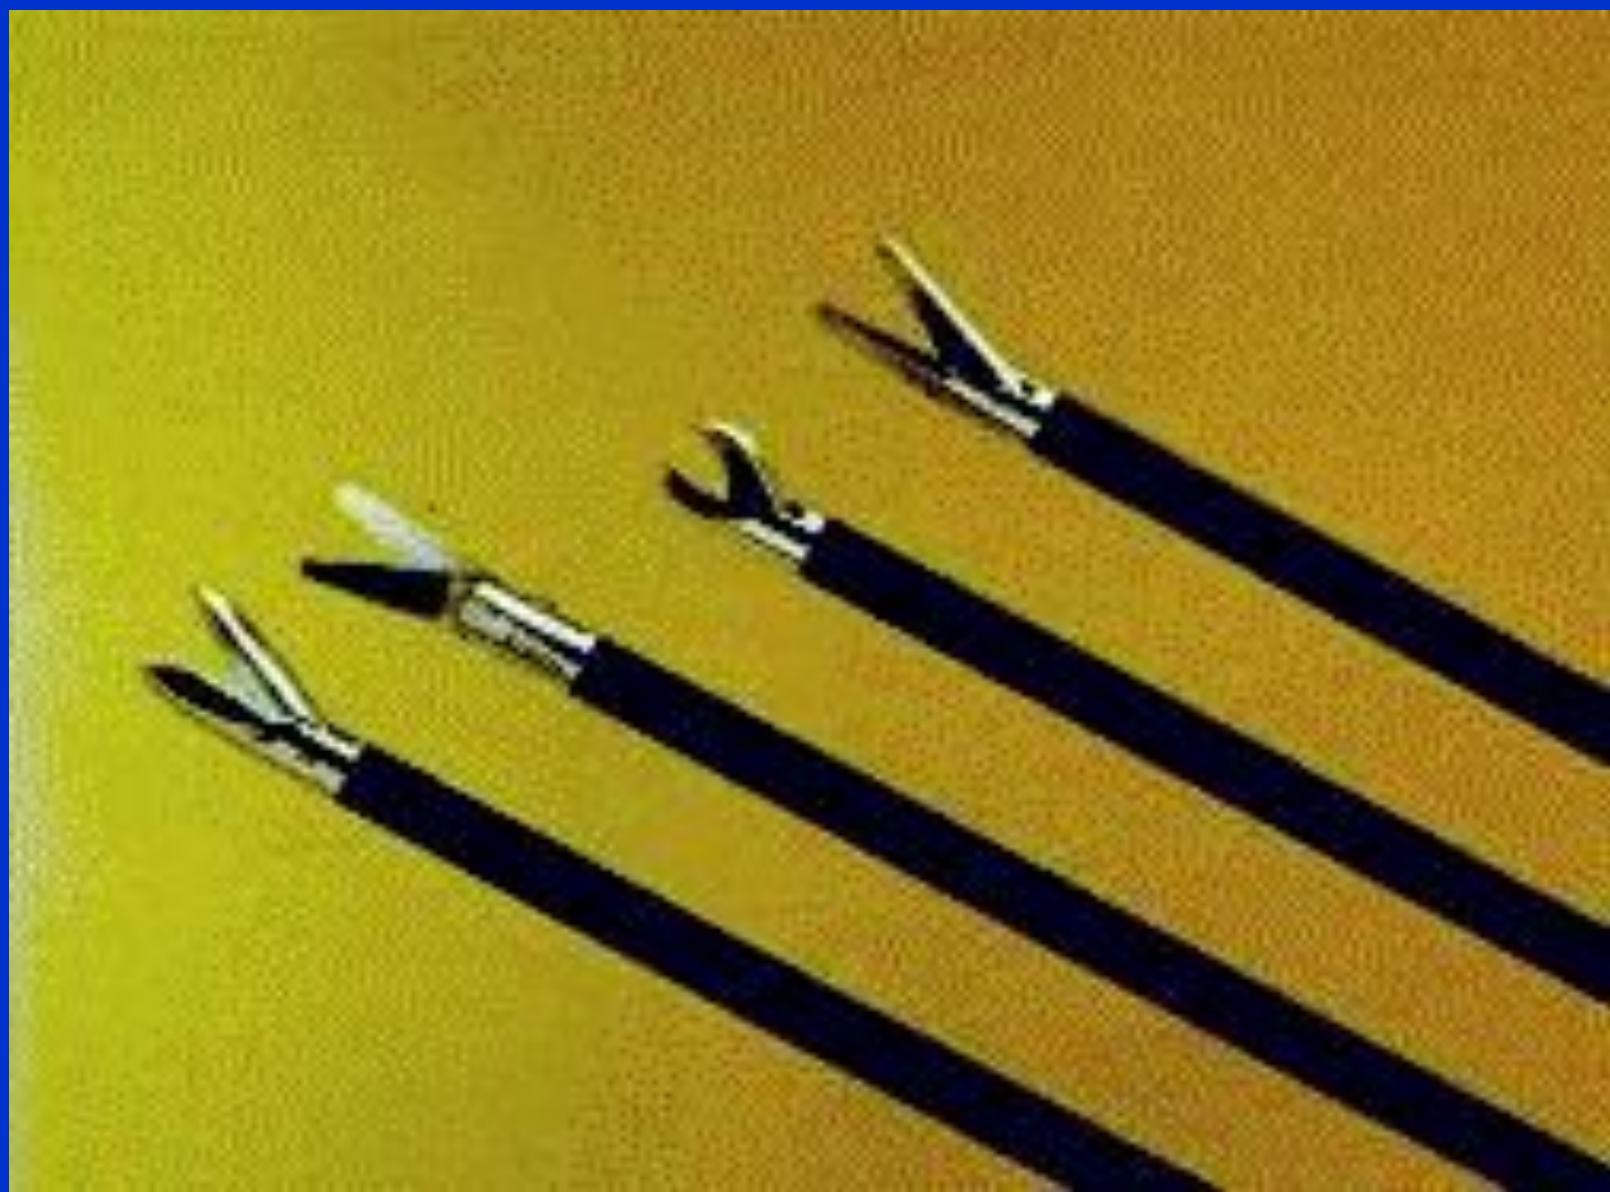











USSC





NUDEH


















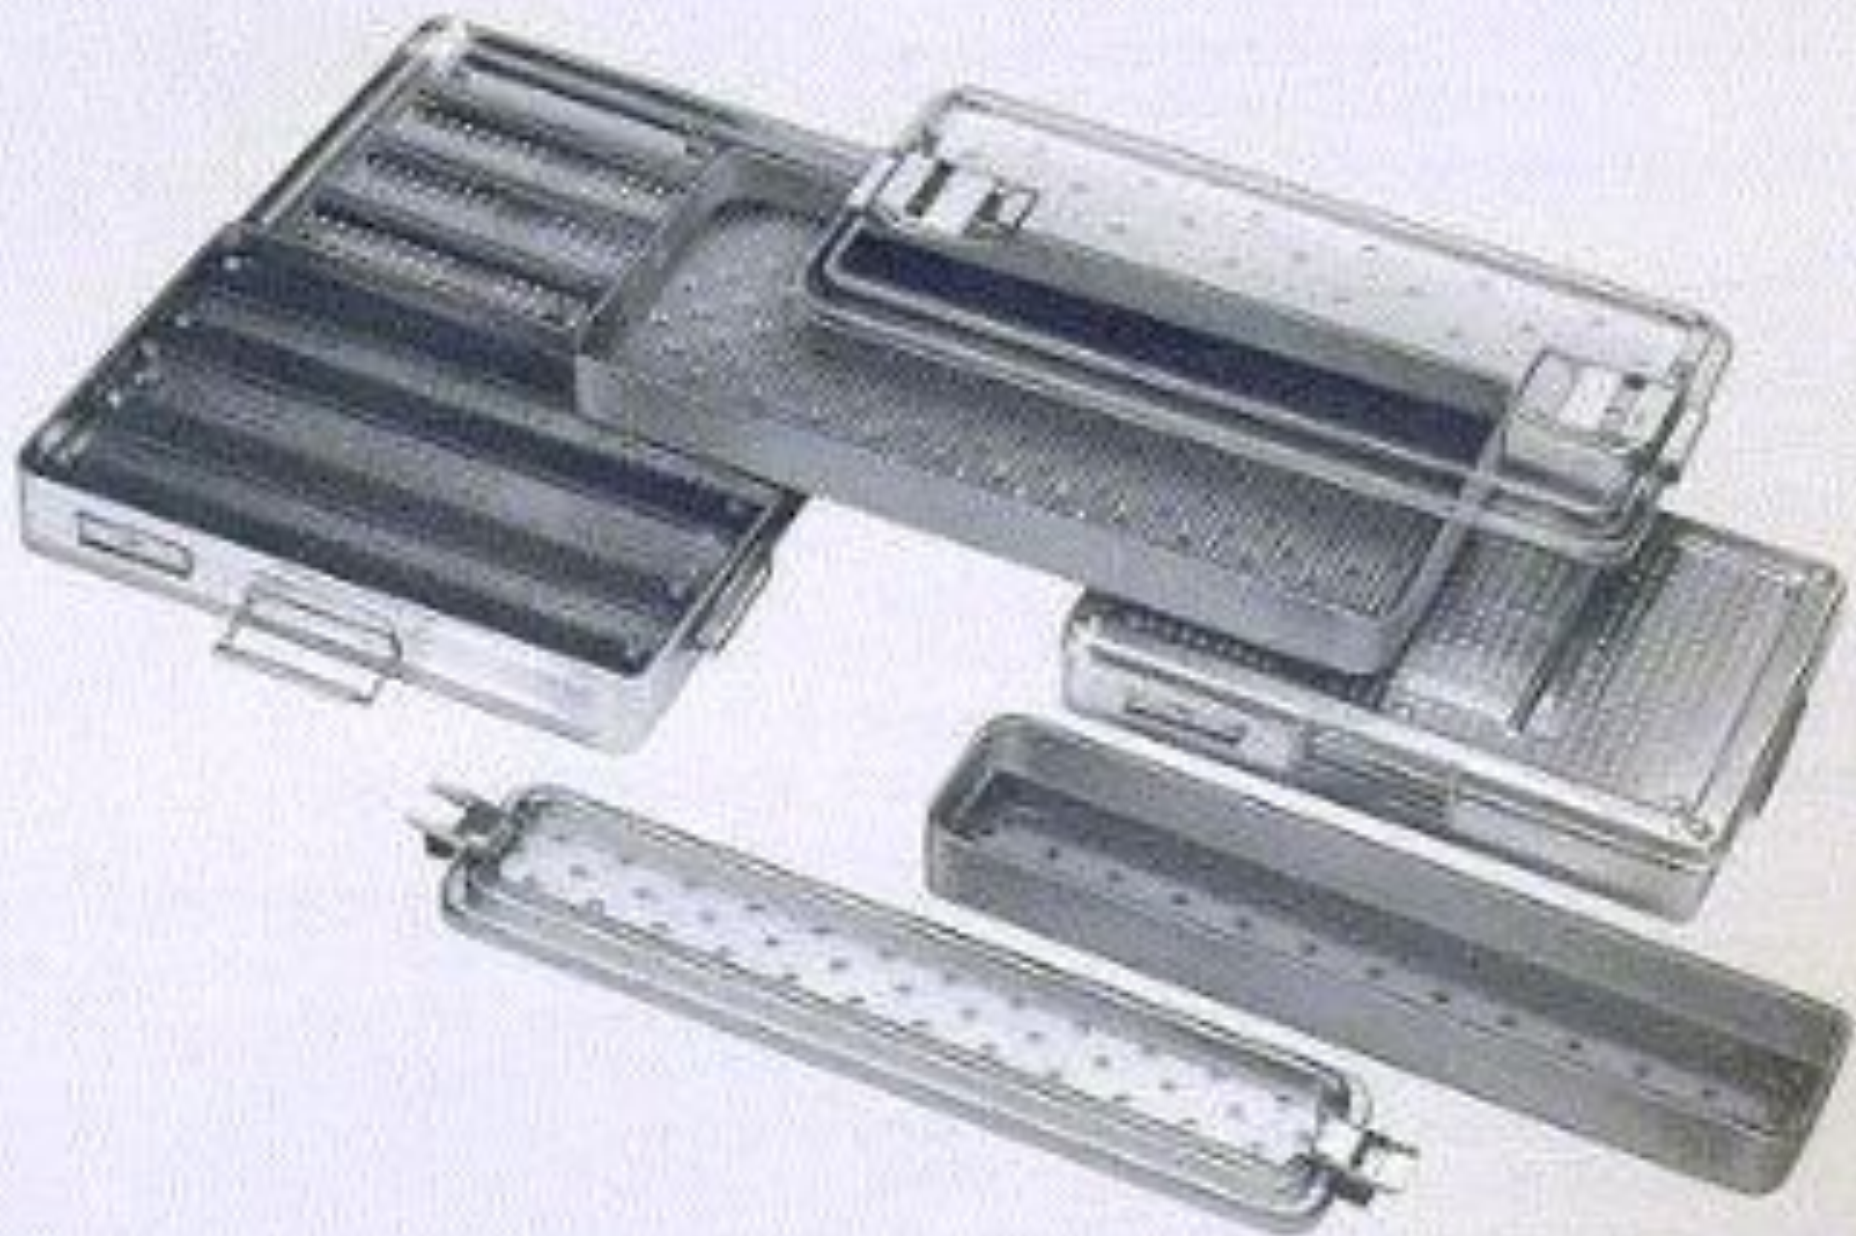

БЛАГОДАРЮ

ЗА

ВНИМАНИЕ